

湖北省医用耗材集中采购 交易系统操作手册

温馨提示：系统目前支持 ie9 及以上、火狐、搜狗、360 极速模式、谷歌、QQ 等主流浏览器，如果出现系统不能点的情况，可以换个浏览器试一下 建议用火狐或者谷歌，安全性和兼容性相对较好。

一、 登录系统

打开网址 <http://www.hbyxjzcg.cn/>。

如图（1）所示：



图（1）

点击“湖北省医用耗材集中采购系统”进入系统登陆页，输入用户名，密码。如图（2）所示：



图（2）

二、修改密码

登录系统后，点击右上方【修改密码】，对密码进行修改，如图（3）、（4）所示：




图(3)



图(4)

三、 进入交易系统

点击系统主界面的【交易系统】进入交易系统，如图（5）：

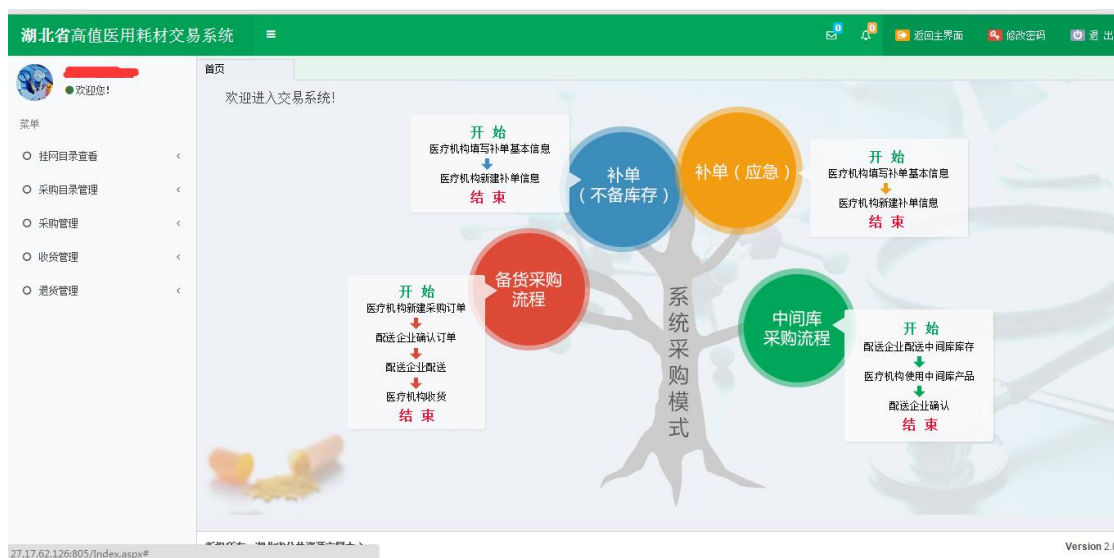

图（5）

交易系统主界面已给出系统采购模式：

- 备货采购
- 中间库采购
- 补单（不备库存）
- 补单（应急）

详细内容请在系统中查看。

四、 挂网目录查看

1、系统功能说明：

挂网目录功能主要供医疗机构查询系统所有的目录数据。

2、系统操作说明：

点击左侧菜单【挂网目录查看-挂网目录查看】进入挂网目录查看功能，可查看系统中可采购的所有目录。如图（6）所示：

图（6）

挂网目录默认显示组件列表，也可以点击页面上方的【CODE列表】，【组套列表】查看 CODE 和组套。

五、 采购目录管理

1、系统功能说明：

系统挂网目录是供全省医疗机构采购的“大目录”，但“大目录”中“数据多维护麻烦，且医疗机构并不是每条目录都会采购。采购目录管理功能就是给医疗机构从“大目录”中勾选出需要

等管理功能

产地: --全部-- 状态: --全部-- 申报企业名称: 请输入...

生产企业名称: 请输入... 注册证编号: 请输入... 查询

组件编号	目录分类	组件名称	注册证规格	注册证型号	产地	单位	配送企业 (点击修改)	状态	CODE数
2	血管介入	消融导管 (商品名Livewire T	402120,直径,7F,电极间距 402112,直径,7F,电极间距 402113,直径,7F,电极间距 402114,直径,7F,电极间距 402115,直径,7F,电极间距 402275,直径,7F,电极间距 402277,直径,7F,电极间距 402278,直径,7F,电极间距 402123,直径,7F,电极间距	402120/402121/402122	进口	盒	+	✓	
3	口腔科耗材	微型螺钉	MS-2205、MS-2207、MS-MS-2205、MS-2207、MS-		进口	盒	+	✓	
4	血管介入	室间隔缺损封堵器 (商品名: 膜部室间隔缺损封堵器-9-V5			进口	盒	+	✓	
5	眼科耗材	眼科手术刀	隧道刀、高尔夫刀、R型(植入)侧切口穿刺刀: MST15、M		进口	包	+	✓	
6	口腔科耗材	齿科骨粉用支撑钛膜	SM1W4875B,SM2W10129 SM1W4875B,SM2W10129		进口	盒	+	✓	

共 2 页 10 1-10 共 11 条

删除采购目录 启用采购目录 禁用采购目录

图 (8)

添加配送企业

组件信息

组件编号: 00000020 组件名称: 气囊式创口贴

目录分类: 血管介入

生产企业: 杭州能可爱心医疗科技有限公司

配送企业注册号: 请输入... 配送企业名称: 请输入... 查询

选择	配送企业注册号	配送企业名称	联系人	联系人座机	联系人手机
<input checked="" type="radio"/>	J0003	湖北通用药业有限公司(原湖北星河医药有限公司)	袁萍	027-82741552	18627013278

共 1 页 1-1 共 1 条

保存

图(9)【选择后点击保存即可】

六、 采购管理

1、 系统功能说明

采购管理主要是医疗机构新建采购订单，新建使用单，补单、查看订单、明细等功能。

2、 系统操作说明

● 新建采购

点击左侧菜单【采购管理-新建采购】进入新建采购页面，如图（10）。根据实际情况选择采购模式，要求实际采购与网上采购一致。



图（10）

进入后，可看到每个采购模式中的采购流程,如备货采购，如图（11）。按照流程一步步操作即可。



图（11）

注意：

1、 医疗机构选择采购品规时，系统会给出此品规的全省历史采购最低价、最高价、平均价等供医疗机构参考。

2、系统三色九段线将最低价与最高价之间九等分，医疗机构输入采购价格后，可知道采购价格在全省处于什么水平。

3、系统提供便捷订单功能，医疗机构可新建便捷订单模板，在采购时使用。

- 采购列表

点击左侧菜单【采购管理-采购列表】进入采购列表页面，如图（12），可查询所有采购的订单信息。未提交的订单可继续修改提交或者删除。

	订单编号	新建订单时间	提交订单时间	订单截止时间	订单总金额(元)	订单明细数量	订单类型
1	1_Y0444_2015120974531756	2015-12-09 20:42:12		2015-12-11 20:42:00	0	1	备货采购
2	2_Y0444_2015120974504003	2015-12-09 20:41:45		2015-12-11 20:41:44	0	0	中间库采购
3	3_Y0444_2015120956291910	2015-12-09 15:38:18	2015-12-09 15:38:43	2015-12-11 15:38:00	0	1	补单(不备库存)
4	2_Y0444_2015120954837058	2015-12-09 15:14:02	2015-12-09 15:31:22	2015-12-11 15:13:57	0	1	中间库采购
5	1_Y0444_2015120953888749	2015-12-09 14:58:38	2015-12-09 14:59:11	2015-12-11 14:58:00	73,326.00	1	备货采购
6	1_Y0444_2015120953632822	2015-12-09 14:53:55		2015-12-11 14:53:00	0	0	备货采购
7	1_Y0444_2015120953431924	2015-12-09 14:50:51	2015-12-09 14:52:06	2015-12-11 14:50:00	989.00	1	备货采购
8	1_Y0444_2015120950829612	2015-12-09 14:07:13		2015-12-11 14:07:00	0	1	备货采购
9	1_Y0444_2015120950505730	2015-12-09 14:01:48		2015-12-11 14:01:00	0	1	备货采购
10	1_Y0444_2015120950215019	2015-12-09 13:57:10		2015-12-11 13:56:00	0	0	备货采购

图（12）

点击订单编号可打印订单信息，系统提供二维码功能，后期可实现扫码审批，扫码入库等。

- 采购明细列表

点击左侧菜单【采购管理-采购明细列表】进入采购明细列表页面，如图（13），可查询所有状态下的采购的订单明细信息。

订单明细条件 > 已确认未配送 ✖

订单明细状态: 未确认 已确认未配送 已配送未收货 已收货 拒收 拒绝配送

订单类型: 备货采购 中间库采购 补单预选采购 补单待选采购 更多

订单明细列表							
	订单编号	目录分类	组件编号	CODE编号	产品名称	产品规格	产品
1	1_Y0444_2015120953888749	血管介入	00000020	0000002066	气囊式创口贴	200mmX60mm	NZ-B-CKT

1 - 1 共 1 条

图（13）

七、收货管理

1、 系统功能说明

备货采购流程中，配送企业配送后，医疗机构需对配送产品验收货物。

2、 系统操作说明

(1) 点击左侧菜单【收货管理-收货】进入收货页面，如图（14），输入收货数量，点击【收货】按钮即可。

收货

填写订单基本信息 选择采购组件 选择规格型号，填写数量、价格；提交订单 配送企业确认订单 配送企业配送 医疗机构收货

组件编号: 组件名称: 目录分类: 全部

生产企业名称: 注册证编号: 查询

收货明细列表												
	拒收原因	订单编号	收货数量	配送数量	配送时间	目录分类	组件编号	CODE编号	产品名称	产品规格	产品型号	采购
1	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>		2015-12-09	血管介入	00000020	0000002066	气囊式创口贴	200mmX60mm	NZ-B-CKT	22

1 - 1 共 1 条

收货 拒收

图（14）

注意：如收货时，货物不对或货物损毁等情况，可选择拒收，勾选配送明细，点击【拒收】按钮即可。

(2) 点击左侧菜单【收货管理-收货列表】进入收货查看页面，可查看系统所有的收货记录，如图（15）。

订单编号	收货数	配送数	配送时间	目录分类	组件编号	CODE编号	产品名称	产品规格	产品型号	采购数	配送企业名称	生产企业名称
1_Y0444_201512095388120	20	20	2015-12-09	血管介入	00000020	0000002066	气囊式创口贴	200mmX60mmNZ-B-CKT	22	22	湖北通用药业有限杭州能可爱心医疗	

图（15）

八、 退货管理

1、 系统功能说明

备货采购中，产品收货后，如发现货物损坏或其他需要退货的情况，可使用退货功能完成退货。

2、 系统操作说明

(1) 点击左侧菜单【退货管理-退货】进入退货页面，如图

(16)，在系统中可看到退货流程，按照系统流程一步步操作即可。

填写退货单基本信息

退货单类型: 退货订单

退货单编号: 5_Y0444_2015120976627053

退货时间: 2015-12-11 21:17:00

备注: 备注

下一步

图 (16)

退货单编号: 请输入...

新建退货单时间: 起始时间 - 结束时间

提交退货单时间: 起始时间 - 结束时间

退货单截止时间: 起始时间 - 结束时间

退货单状态: --全部--

查询

采购退货单列表

退货单编号	新建退货单时间	提交退货单时间	退货单截止时间	退货单总金额	退货单明细数	退货单状态	备注
5_Y0444_2015120954284615	2015-12-09 15:04	2015-12-09 15:08	2015-12-11 15:04	39996	1	已提交	

1 共 1 页 10

新增退货单 删除退货单

图 (17)

(2) 点击左侧菜单【退货管理-退货列表】进入退货列表页面，
可查看所有退货记录，如图 (17)。