

湖北省高值医用耗材集中挂网阳光采购平台

更新产品分类操作手册

一. 登录


点击湖北省药械集中采购服务平台（以下简称平台，<http://www.hbyxjzcg.cn>），进入湖北省高值医用耗材集中采购系统-基础数据库，登录账号及密码为企业注册号（如 HCS**、J 类型）及密码。



二、更新产品分类操作

中心端近期更新了湖北省高值医用耗材基础库产品分类，需要企业在**平台注册的所有产品**（除以后不在湖北销售的产品以外），均在规定时间内完成产品分类名称的更新。

1. 点击“产品信息管理”-“组件管理”，如图（1）

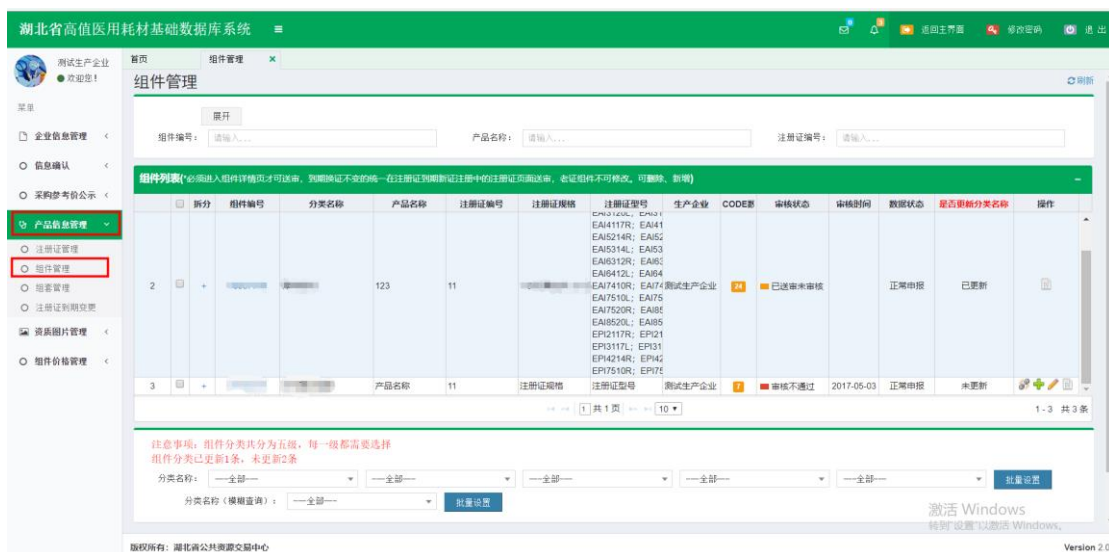

图（1）

2. 列表页面滑到最下方，可以对产品的组件分类进行批量设置，批量设置的方式分为两种。

第一种：参考“高值医用耗材申报目录”，根据某产品实际分类和名称，自行选择出一到五级的分类，然后勾选需要更新的组件，点击批量设置按钮。如图（2）



图（2）

第二种：参考 “高值医用耗材申报目录”，在“产品名称”处模糊查询找到对应产品的品种名，勾选需要变更的组件，点击批量设置按钮。如图（3）



图（3）

注意事项：

（1）第一种和第二种批量设置方法均可通过网站公布的“高值医用耗材申报目录”快速查找与实际产品相近的产品名称，从而倒推所需要勾选的五级目录或产品名称。

（2）对于高值医用耗材申报目录中未涉及的低值产品，请直接在产品五级目录中勾选“低值类”。

（3）第一种设置方法必须选满一到五级才能进行变更。

（4）为方便企业查看，系统支持“多条件”搜索，企业点击“产品信息管理”-“组件管理”界面左上角的“展开”键可查。

三. 更新情况查看

点击“产品信息管理”-“组件管理”界面左上角的“展开”键，根据“是否更新分类名称”的查询条件，可以查询本企业哪些组件已更新，哪些组件还未更新，避免遗漏。如图（4）



图（4）

四、CODE 反选组件

由于原有的湖北省高值医用耗材产品结构为 code 对应材质，组件在材质上不区分。但此次涉及的更新产品分类却需要对组件在材质上区分，在这种情况下，企业需要修改原组件的材质，并新增一个新材质的组件，同时将已注册的某 code 反选到新材质的组件下。下面主要介绍如何将已注册的 code 反选组件。

湖北省高值医用耗材基础数据库系统

测试生产企业 欢迎您!

菜单

- 企业信息管理
- 信息确认
- 采购参考价公示
- 产品信息管理
- 注册证管理
- 组件管理
- 组套管理
- 注册证到期提醒
- 资质图片管理
- 组件价格管理

首页 组件管理

备注: 备注

保存

拆分组件

组件拆分列表


	CODE编号	产品规格	产品型号	产品码	产品性能描述	产品材质	备注	审核状态	操作
1	000008791227	100mm X35mm	NZ-C-CKT	6947720500063	明箭	聚酰胺、医用聚乙烯	明箭	已送审未审	
2	000008791227	100mm X25mm	NZ-C-CKT	6947720500062	明箭	聚酰胺、医用聚乙烯	明箭	已送审未审	
3	000008791227	100mm X75mm	NZ-C-CKT	6947720500061	明箭	聚酰胺、医用聚乙烯	明箭	已送审未审	

1-3 共3条

激活 Windows

图 (6)

2. 弹出的“组件列表”框中，对需要变更组件的 code，
点击变更按钮，提示“变更成功”则操作完成，如图（7）

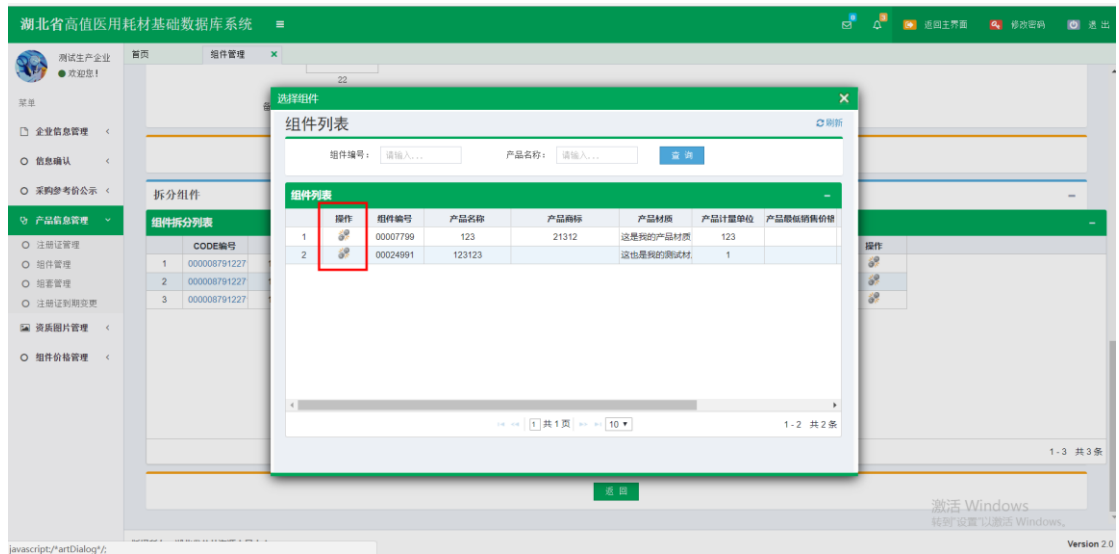

图（7）

注意事项：

- 1、超过中心设定的反选时间，则不能进行反选操作。
- 2、反选后的 CODE 审核状态和反选前一样，例如：反选前 CODE 审核状态为审核不通过，反选后 CODE 状态依然为审核不通过，需要企业再送审后中心审核。